上顎
拡大装置

M.S.E
M.S.E.II

考　案　Won Moon教授（UCLA 大学矯正科）

長年の臨床実績に基づき開発された、
新しいコンセプトのエクスパンションスクリュー。

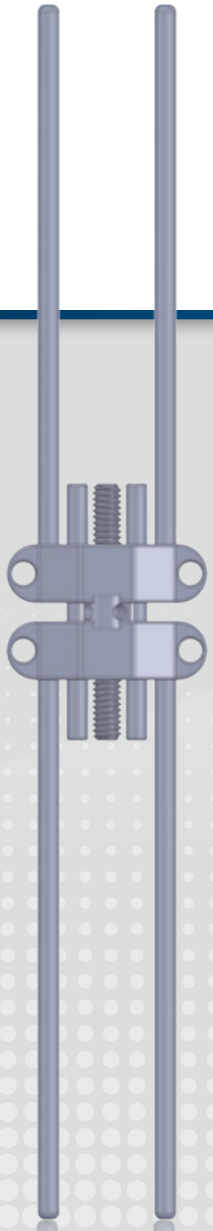

MSE I

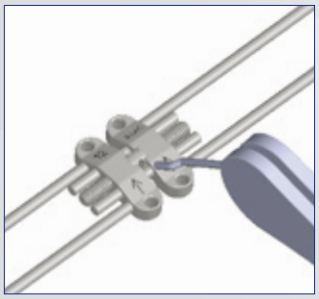

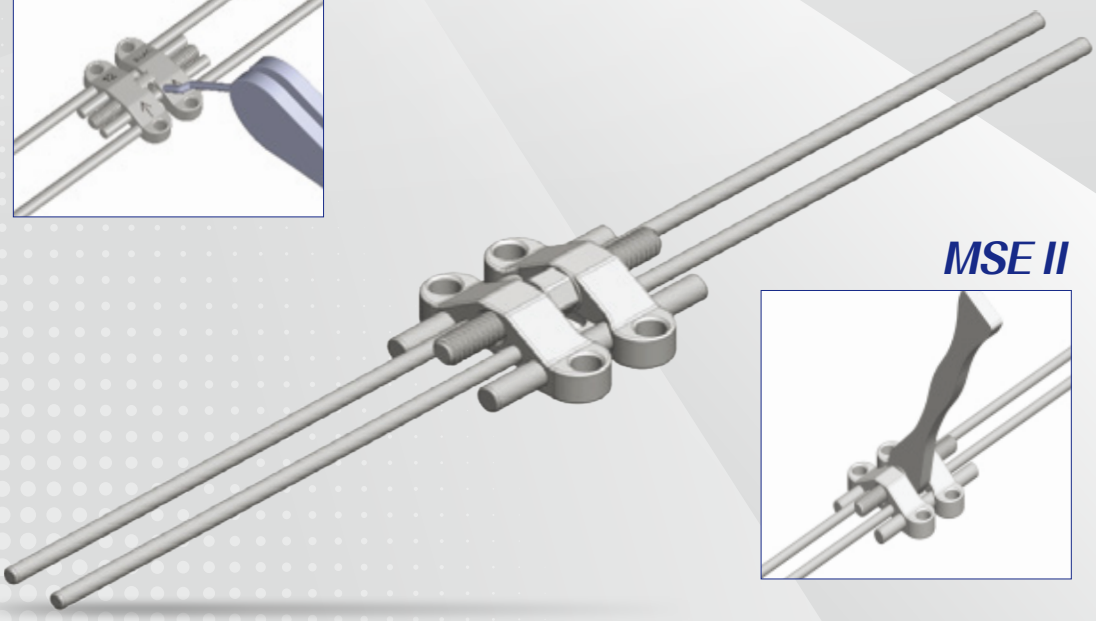

MSE II

Forest-one

上顎拡大装置

MSE Ⅰ / MSE Ⅱ

長年の臨床実績に基づき開発された、
新しいコンセプトのエクスパンションスクリュー。

ハイアングル症例での
効果的な使用も可能。

全年齢の患者に
適用可能。

考　案

Won Moon 教授
UCLA 大学矯正科

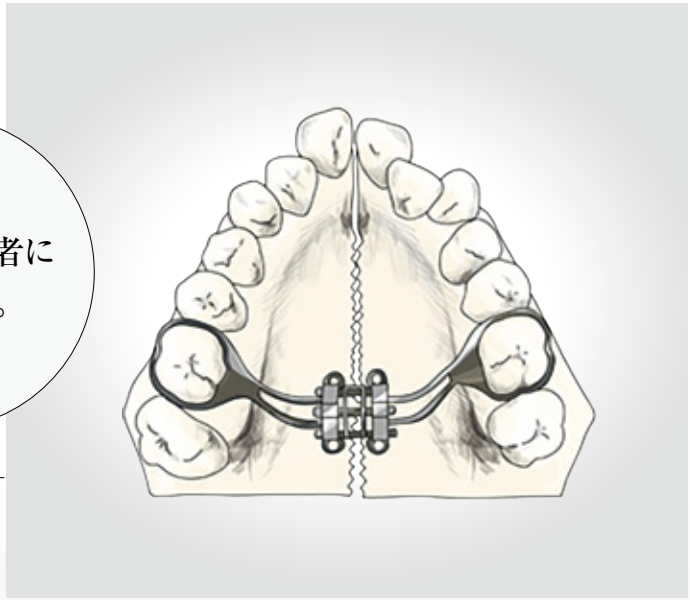

オプション品（別売）

■口蓋固定用ラチェット



■パイロットドリル



■ショートハンドルドライバー

■オプション品（MSE Ⅰ/MSE Ⅱ共通）

商　品　名	サイズ	数　量	標準価格（税別）
専用固定ネジセット 11mm※1	11mm	4本	お問い合わせください
専用固定ネジセット 9mm※1	9mm	4本	お問い合わせください
パイロットドリル　12mm※2	有効長：12mm / 全長：31mm		お問い合わせください
パイロットドリル　9mm※2	有効長：9mm / 全長：28mm		お問い合わせください
口蓋固定用ラチェット※3	—		お問い合わせください
ショートハンドルドライバー※2	—		お問い合わせください
ドライバーシャフト コントラ用ロング※2	全長：35mm		お問い合わせください
ドライバーシャフト コントラ用ショート※2	全長：22mm		お問い合わせください

※1　販売名：バイオマテリアルズ ミニインプラント　医療機器製造販売承認番号：22200BZX00910000　※2　販売名：バイオマテリアルズ ミニインプラント ドライバ　医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000008
※3　販売名：BMK ドライバ　医療機器製造販売届出番号：12B1X10014000030

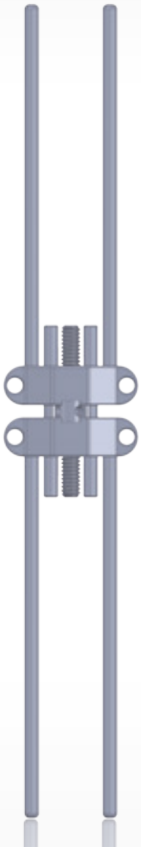



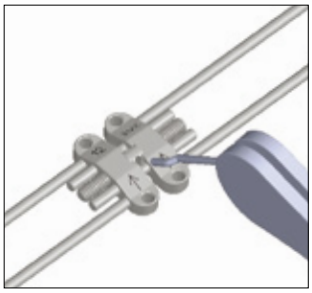

MSE Ⅰ

アームのタイプ　ハード / ソフト

〈構成品〉・MSE本体 …… 1個
・回転用キー …… 1個

■MSEⅠ 商品一覧

販売名:MSEエクスパンションスクリュー　医療機器製造販売認証番号:226ADBZX00158000

商　品　名	スクリュー最大拡大幅	ガイドレール長さ	標準価格（税別）
MSEⅠ　8mmタイプ	8mm	13.4mm	お問い合わせください
MSEⅠ 10mmタイプ	10mm	15.4mm	お問い合わせください
MSEⅠ 12mmタイプ	12mm	17.4mm	お問い合わせください



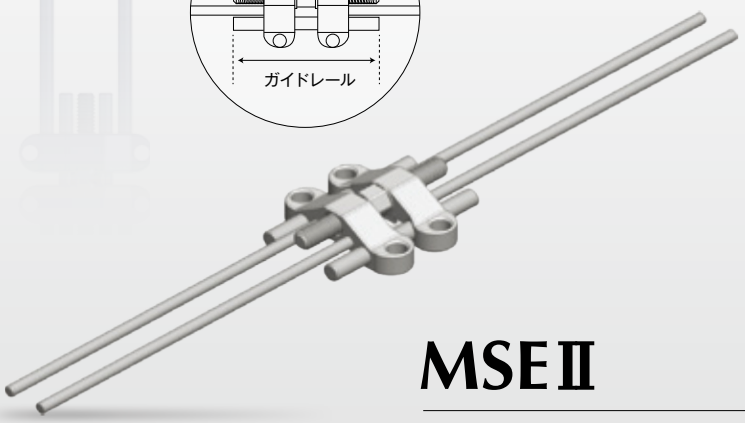

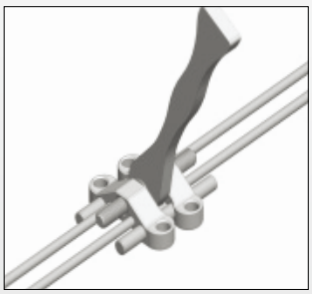

回転レンチを用いることで
より大きな力が加えられます。

MSE Ⅱ

アームのタイプ　ハード / ソフト

〈構成品〉・MSE本体 ……1個
・回転レンチ（長・短）…各1個

■MSEⅡ 商品一覧

販売名:MSEエクスパンションスクリュー　医療機器製造販売認証番号:226ADBZX00158000

商　品　名	スクリュー最大拡大幅	ガイドレール長さ	標準価格（税別）
MSEⅡ　8mmタイプ	8mm	14.1mm	お問い合わせください
MSEⅡ 10mmタイプ	10mm	16.1mm	お問い合わせください
MSEⅡ 12mmタイプ	12mm	18.1mm	お問い合わせください